

# 国際事業戦略 グローバル経営の推進


2017年11月16日

常務取締役 国際事業部長

若槻 一男



# 国際事業部 売上実績（上期連結）

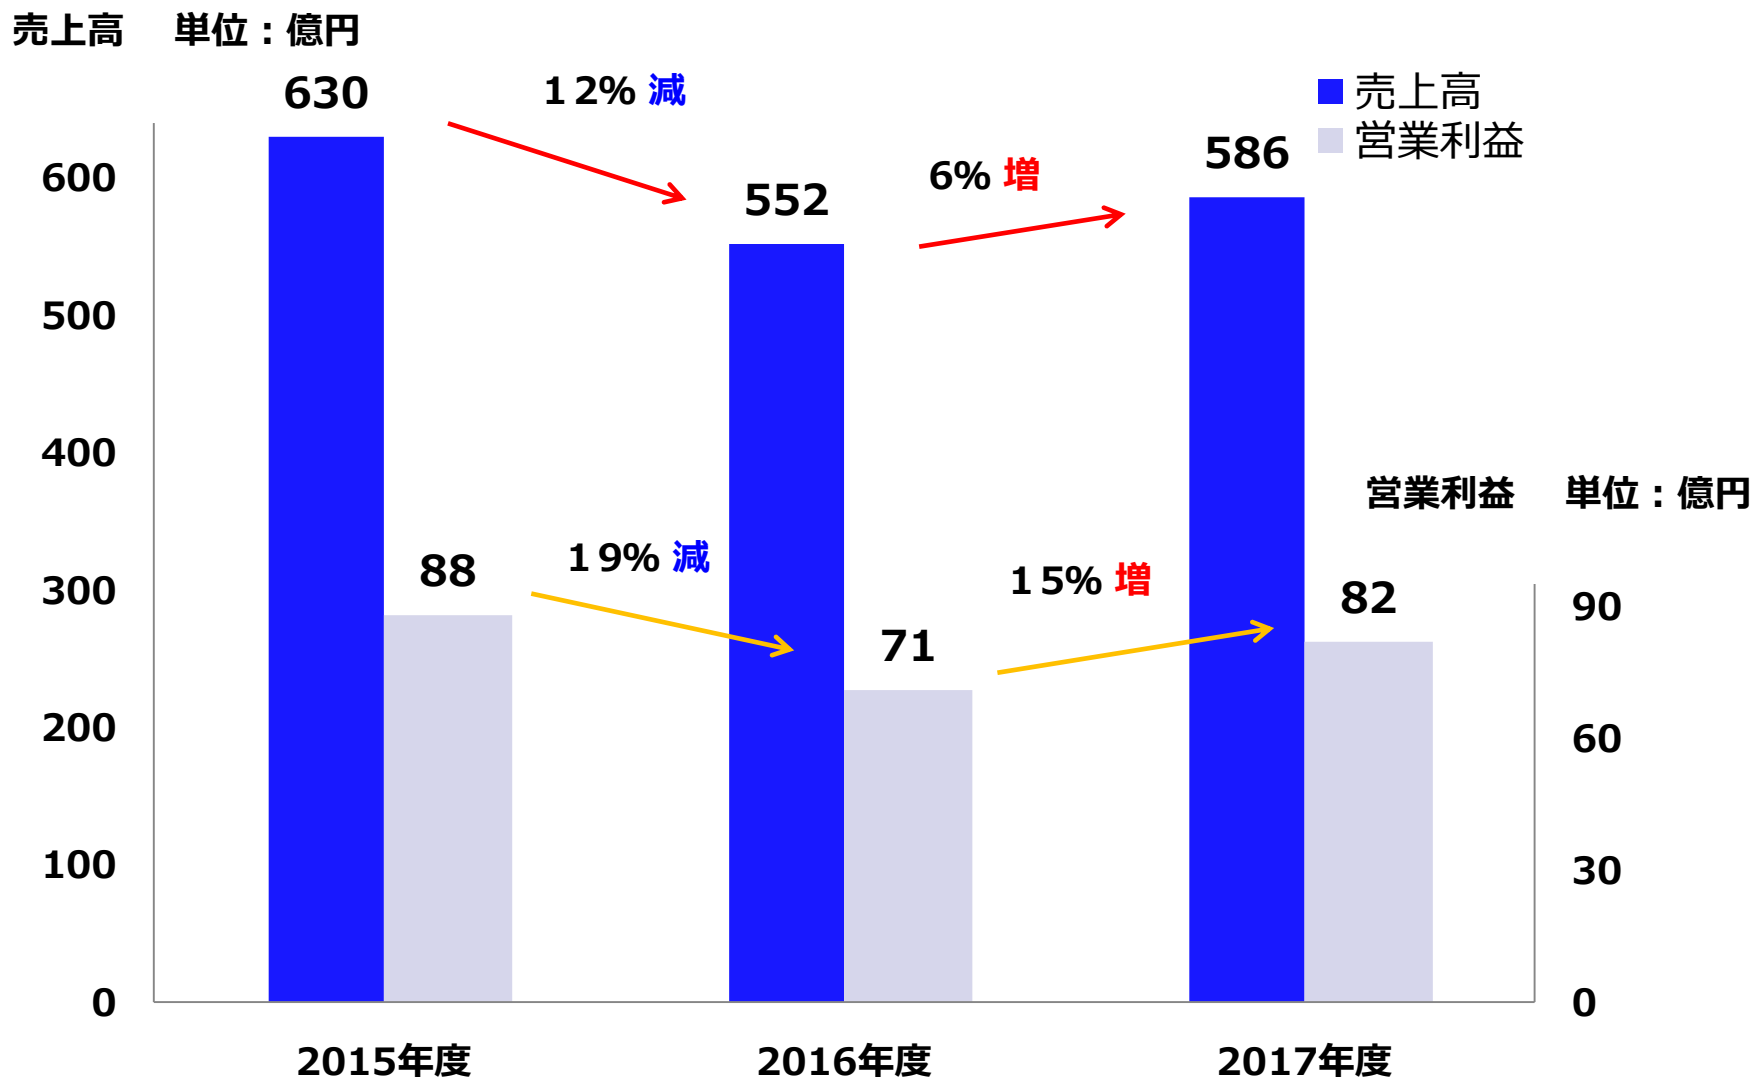

# 国際事業部 地域別売上推移 (上期)

## 【欧州】

(単位:百万ユーロ)




## 【中東】

(単位:百万AED)




## 【中国】

(単位:百万円)




## 【インド】

(単位:1億ルピー)




## 【アフリカ】

(単位:億円)



## 【アジアパシフィック】

(単位:億円)




## 【OEM】

(単位:億円)



## 【北米】

(単位:百万ドル)




## 【連結合計】


(単位:億円)



## 【2017年連結売上】

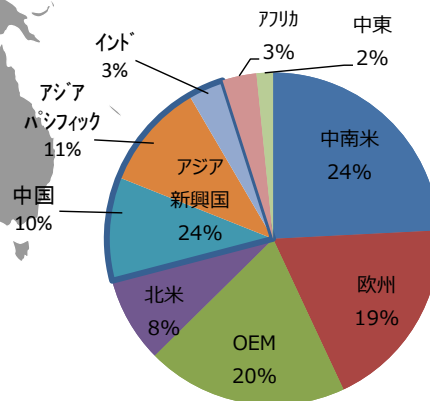

# 国際事業部海外拠点

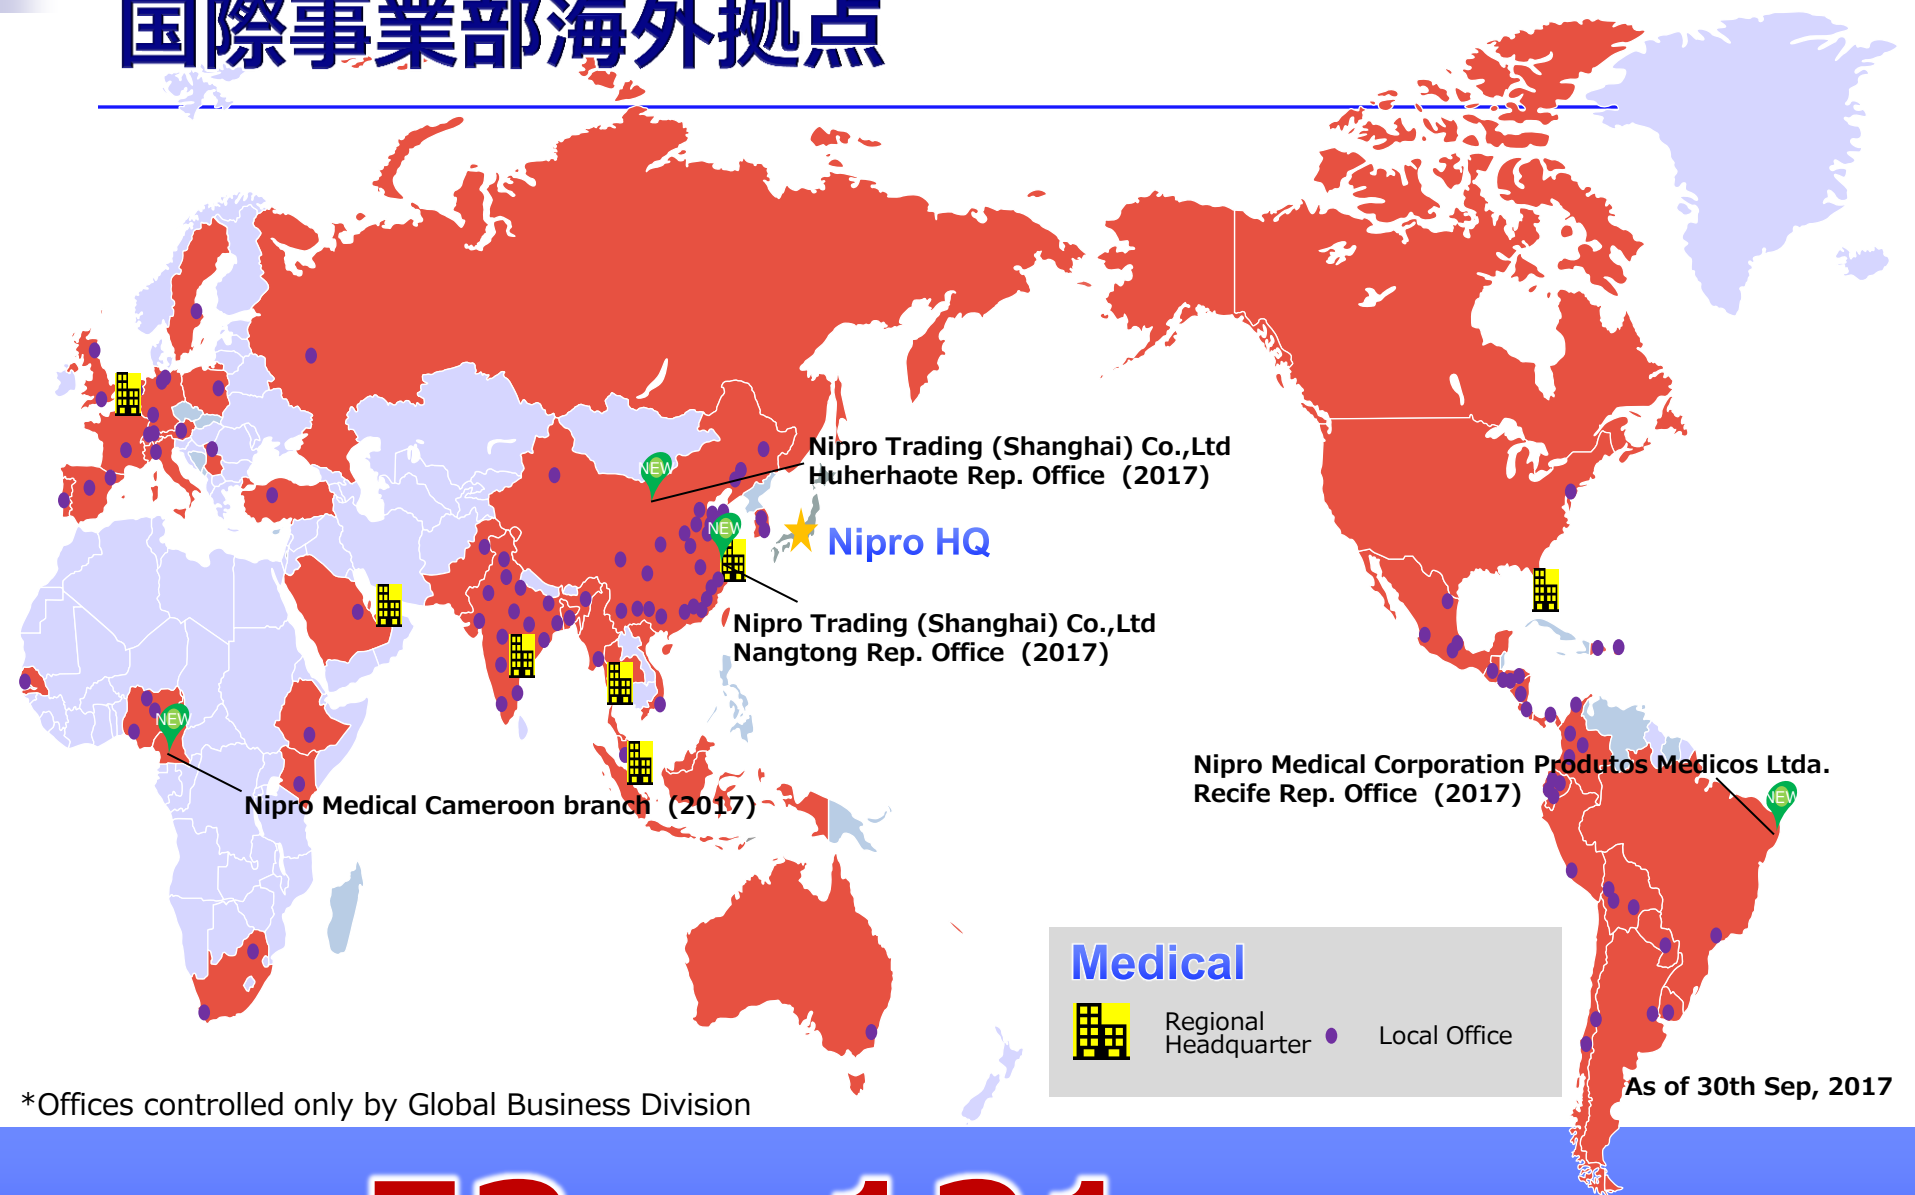

53ヶ国に 121の販売拠点


# 重要市場の状況

## 【最重要市場】

1. 北米
2. 中国
3. インド

# 北米事業の拡大と活動状況


## 売上推移(ニプロブランド製品のみ)

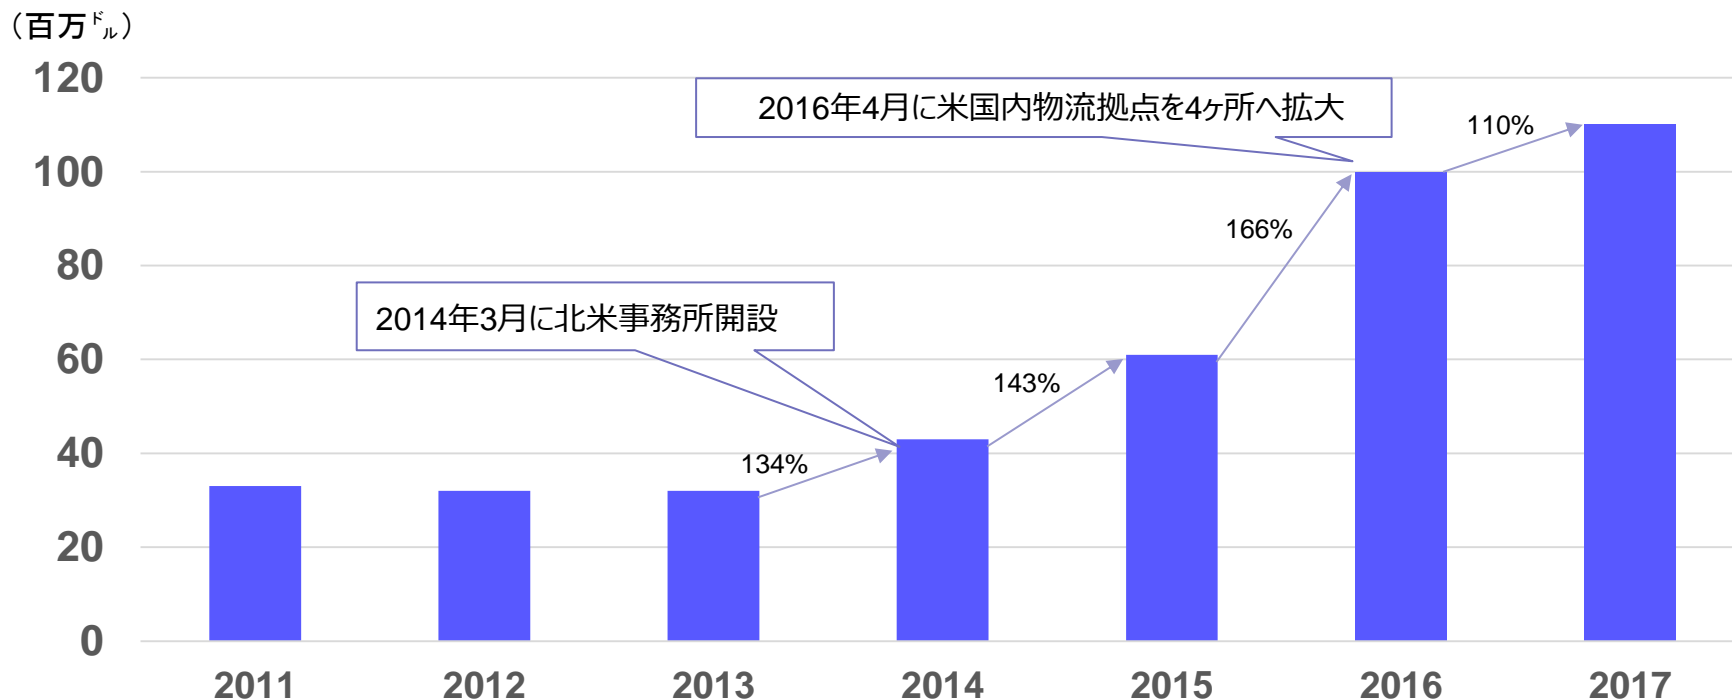

- 透析製品の販売拡大(米国大手透析プロバイダーとの提携強化、新製品導入)
- バスキュラー製品の販売開始(高耐圧PTAバルーン、ガイドワイヤー等)
- カナダ事務所の準備中(2018年1月開設目標)

# 北米事業の拡大と活動状況

## 米国における大手透析プロバイダーとの提携強化

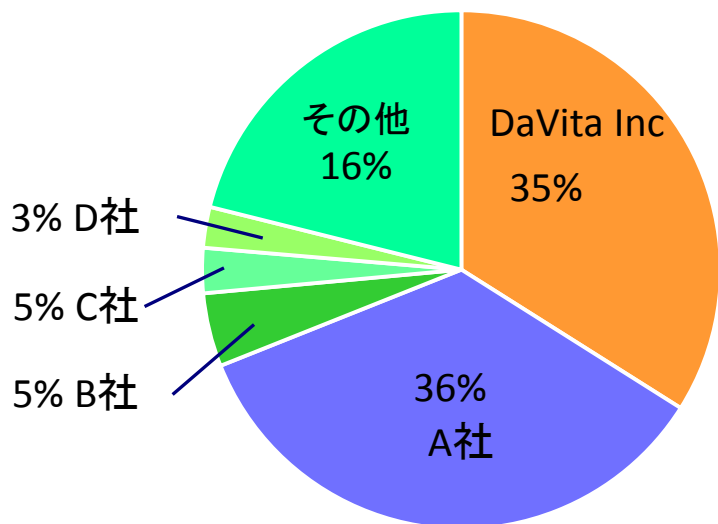

透析グループのシェア  
米国血液透析患者数: 約480千人

DaVitaなど大手5社で、  
米国市場全体の約84%を占める

大手透析プロバイダーとの提携強化は、  
米国透析市場のシェア拡大における絶対条件


# 北米事業の拡大と活動状況

## 大手透析プロバイダーを含む米国における主要製品の納入実績推移


(単位：本)




### Dialyzer

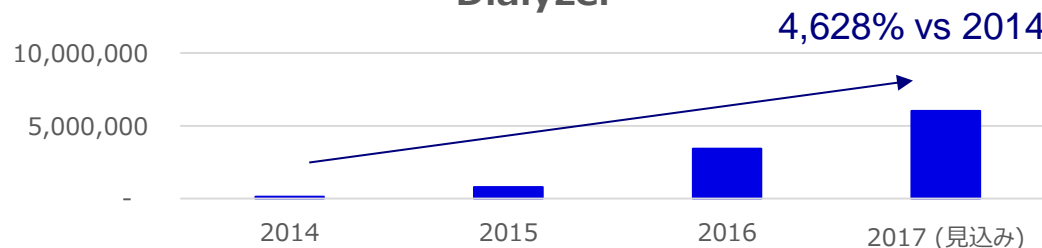

### Bloodline

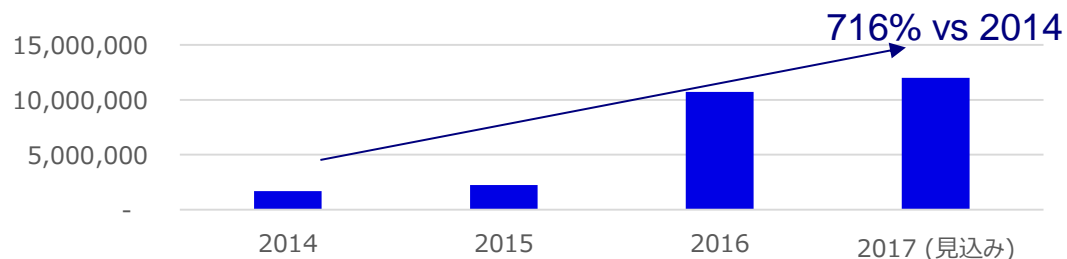


### AVF

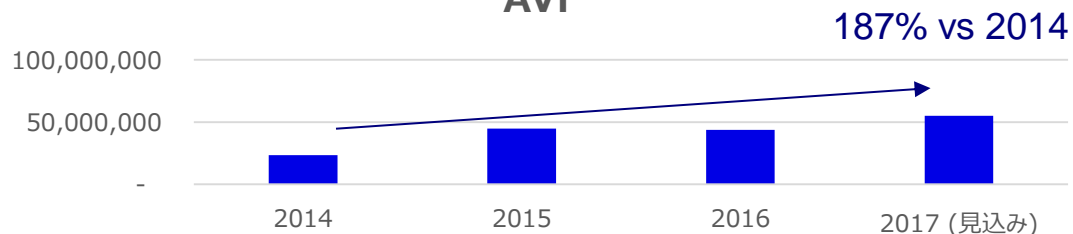




# 尼普洛貿易(上海)の売上推移


単位 千元

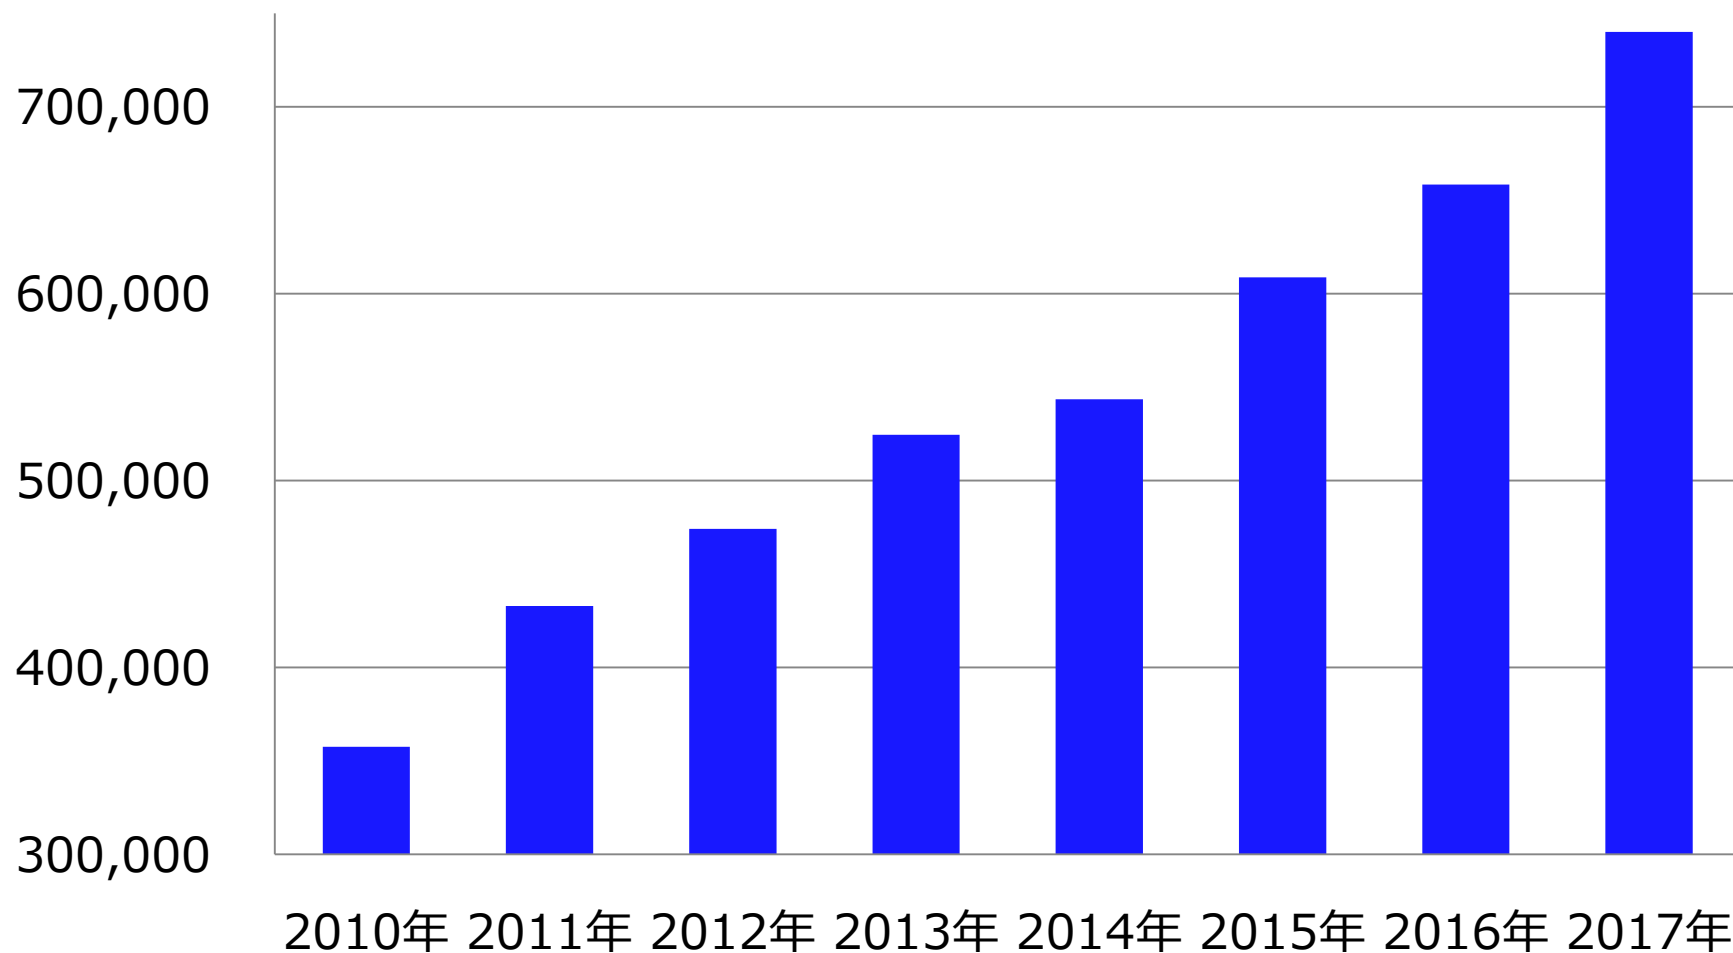

# ニプロ貿易(上海)ダイライザ・透析装置売上数量推移

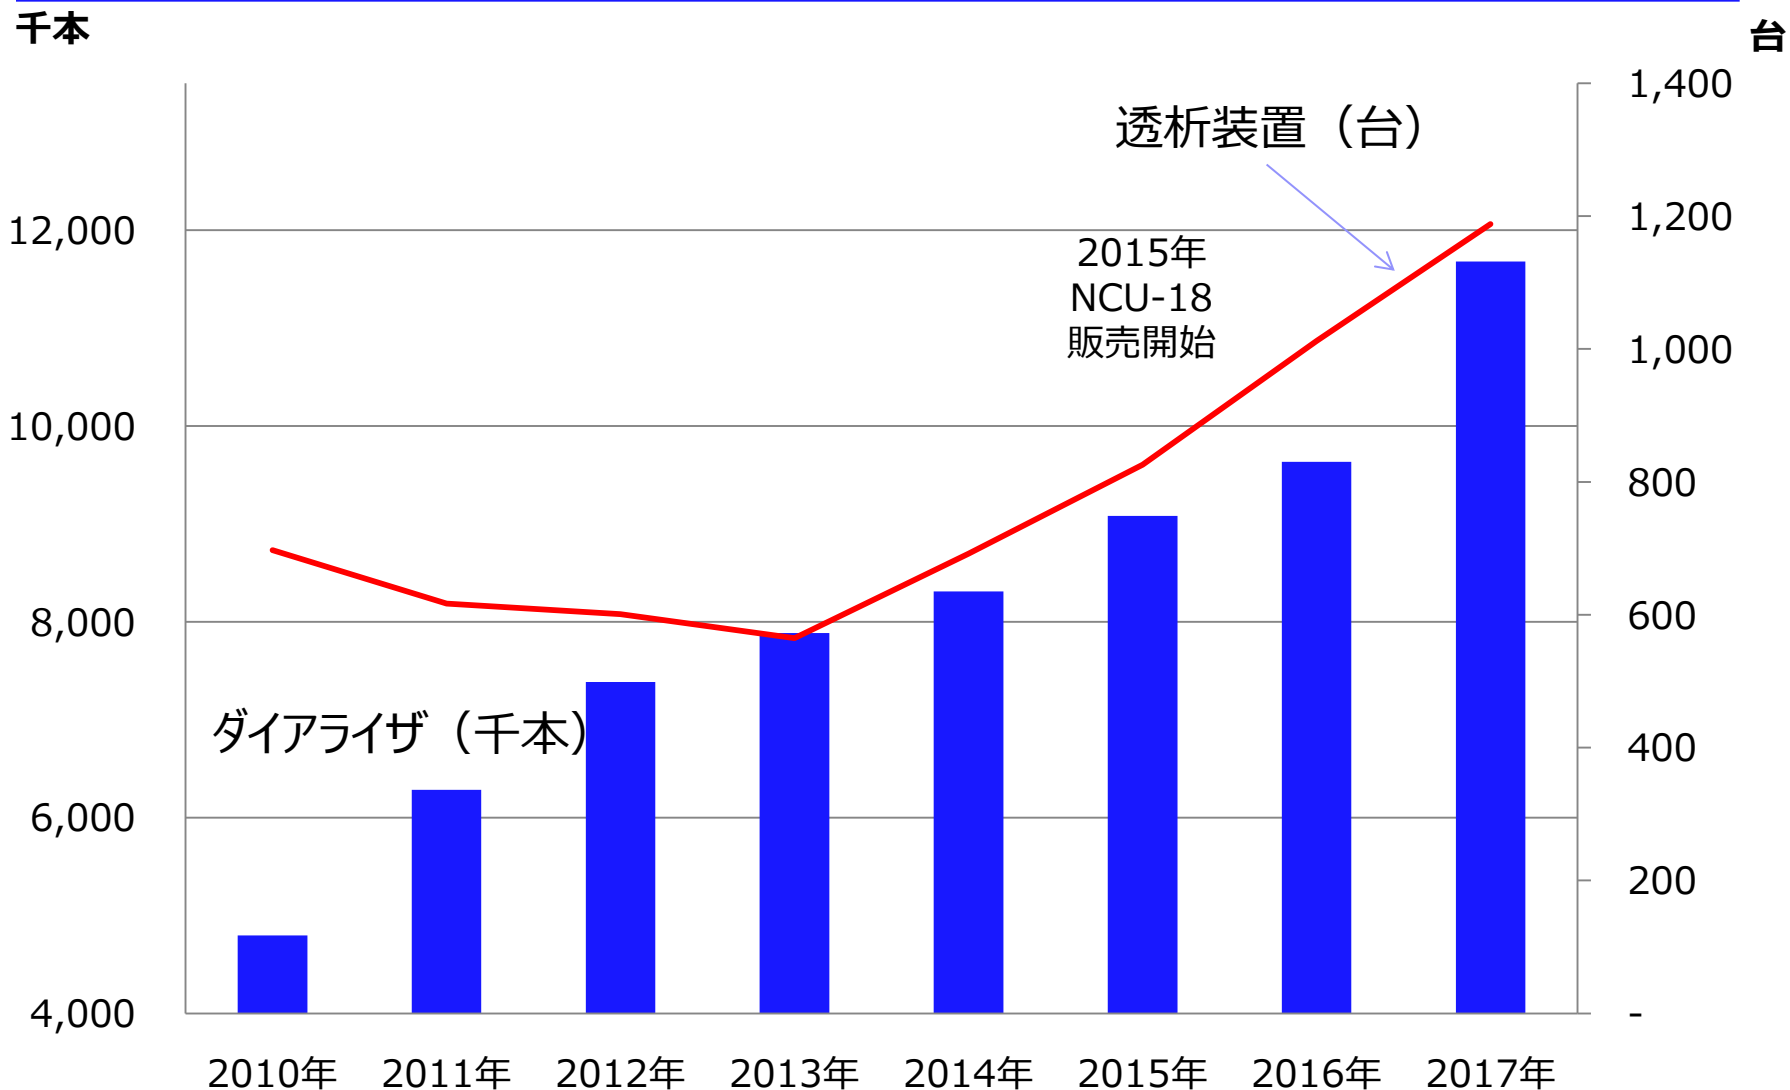

# 中国の透析センター数と患者数推移

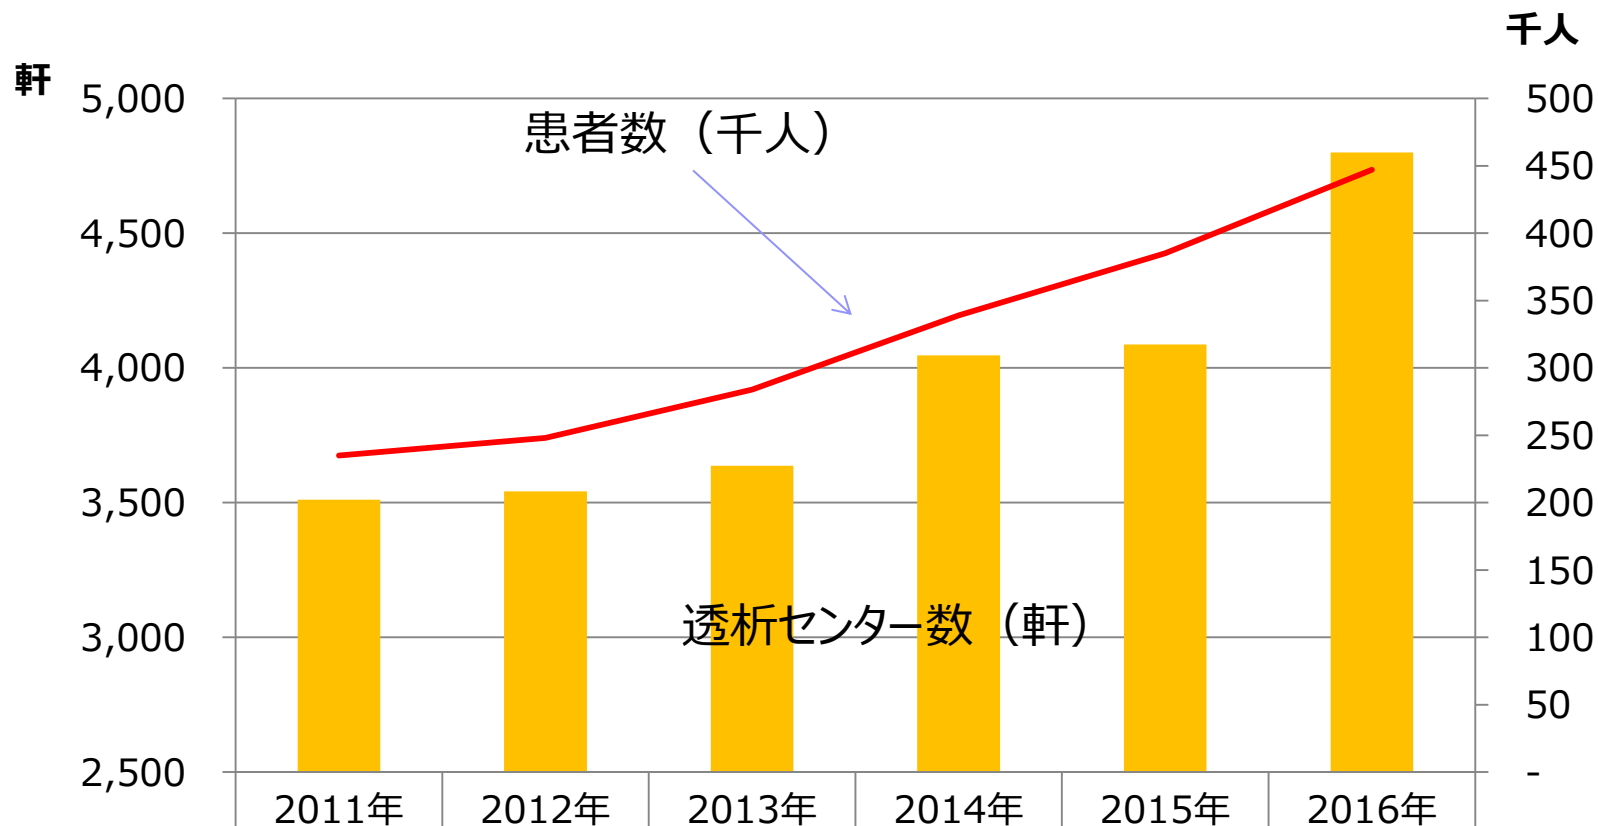


■ 透析センター	3,511	3,542	3,637	4,047	4,087	4,799
— 透析患者数 (千人)	235	248	284	339	385	447

引用：2017年京津冀血液净化质控联盟高峰论坛《全国血液透析质控现状与策略》孙雪峰


# ニプロメディカルインディア 販売実績及び計画

(単位：100万インドルピー)

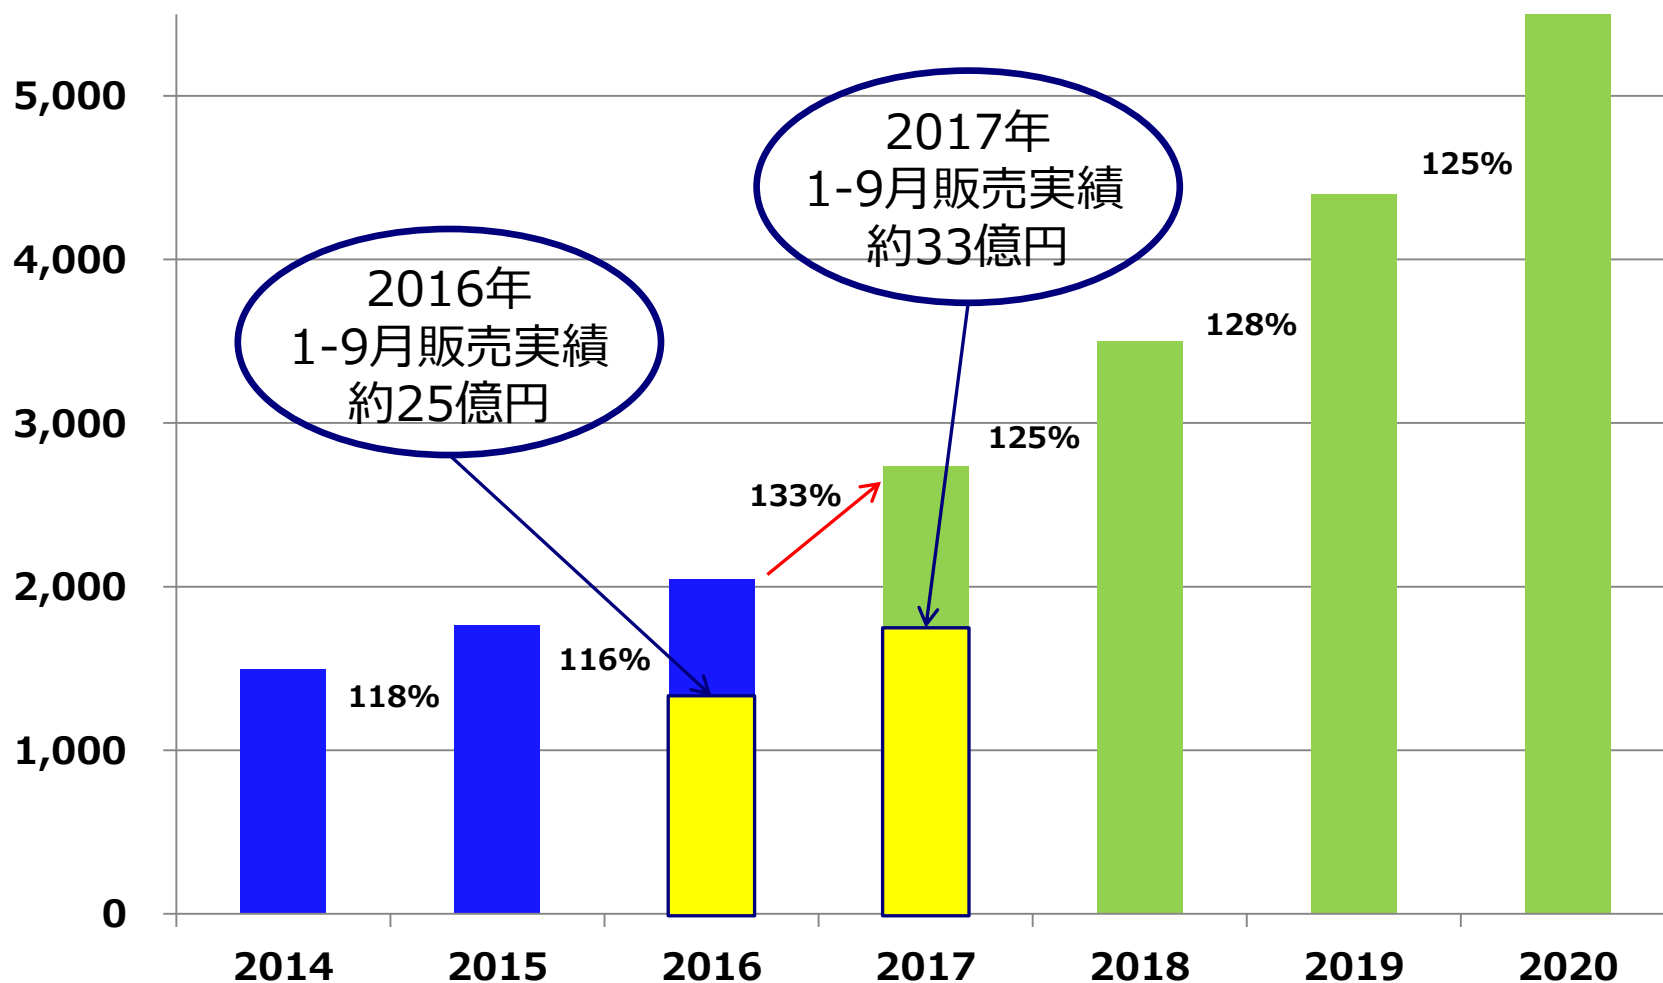

# ニプロメディカルインディア 月別売り上げ実績推移

(単位：100万インドルピー)

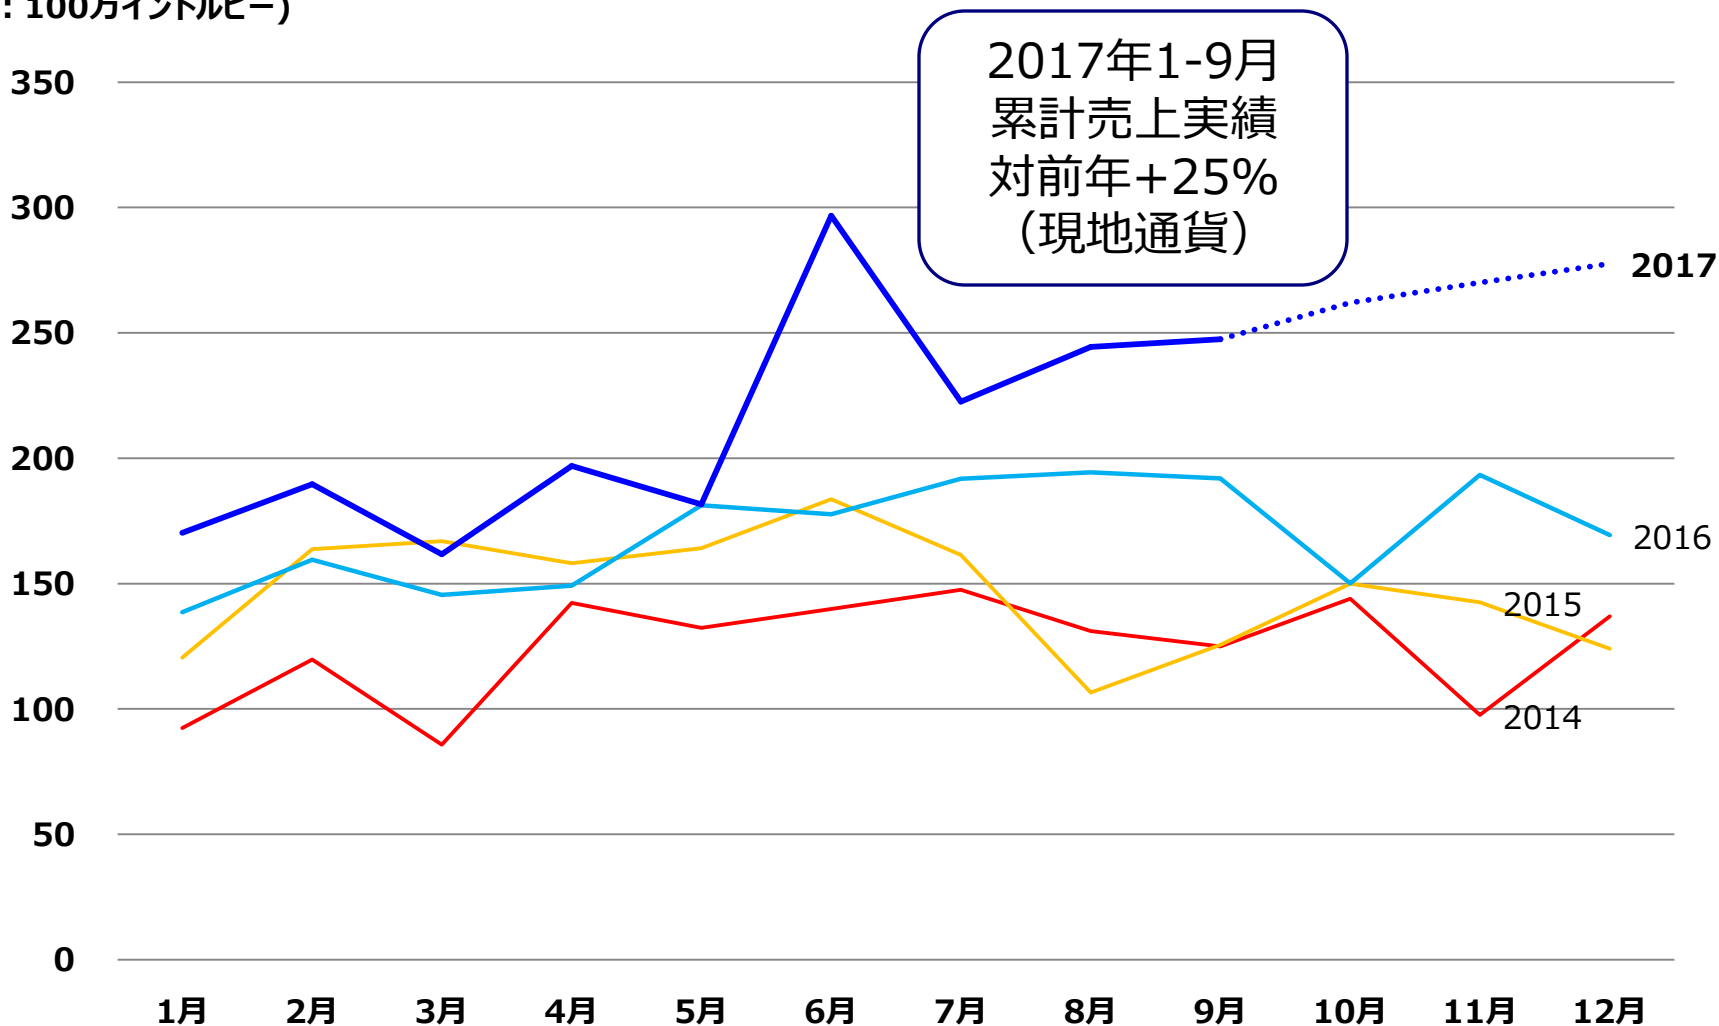


# Public Private Partnership (PPP)



これまでにPPPで**透析装置2,371台**の入札があり、その内**2,001台(84%)**をニプロが獲得

州	入札確定日	センター数	透析装置台数	入札獲得メーカー		
				ニプロ	欧州	日系
1 西ベンガル州	2013年11月	34	230	230		
2 デリー連邦直轄区	2014年1月	10	110		110	
3 マディヤ・プラデーシュ州	2015年1月	42	130			130
4 ビハール州	2015年1月	11	110		110	
5 ウットタル・プラデーシュ州	2016年7月	36	360	360		
6 ハリヤーナー州	2016年8月	10	120	120		
7 ウッタラーカンド州	2016年12月	5	50	30	20	
8 ジャールカンド州	2016年12月	6	48	48		
9 トリプラ州	2016年12月	6	30	30		
10 アーンドラ・プラデーシュ州	2017年1月	21	214	214		
11 ケーララ州	2017年2月	24	240	240		
12 カルナータカ州	2017年3月	129	460	460		
13 テランガーナ州	2017年6月	39	269	269		
合計			2,371	2,001	240	130

# Public Private Partnership (PPP)

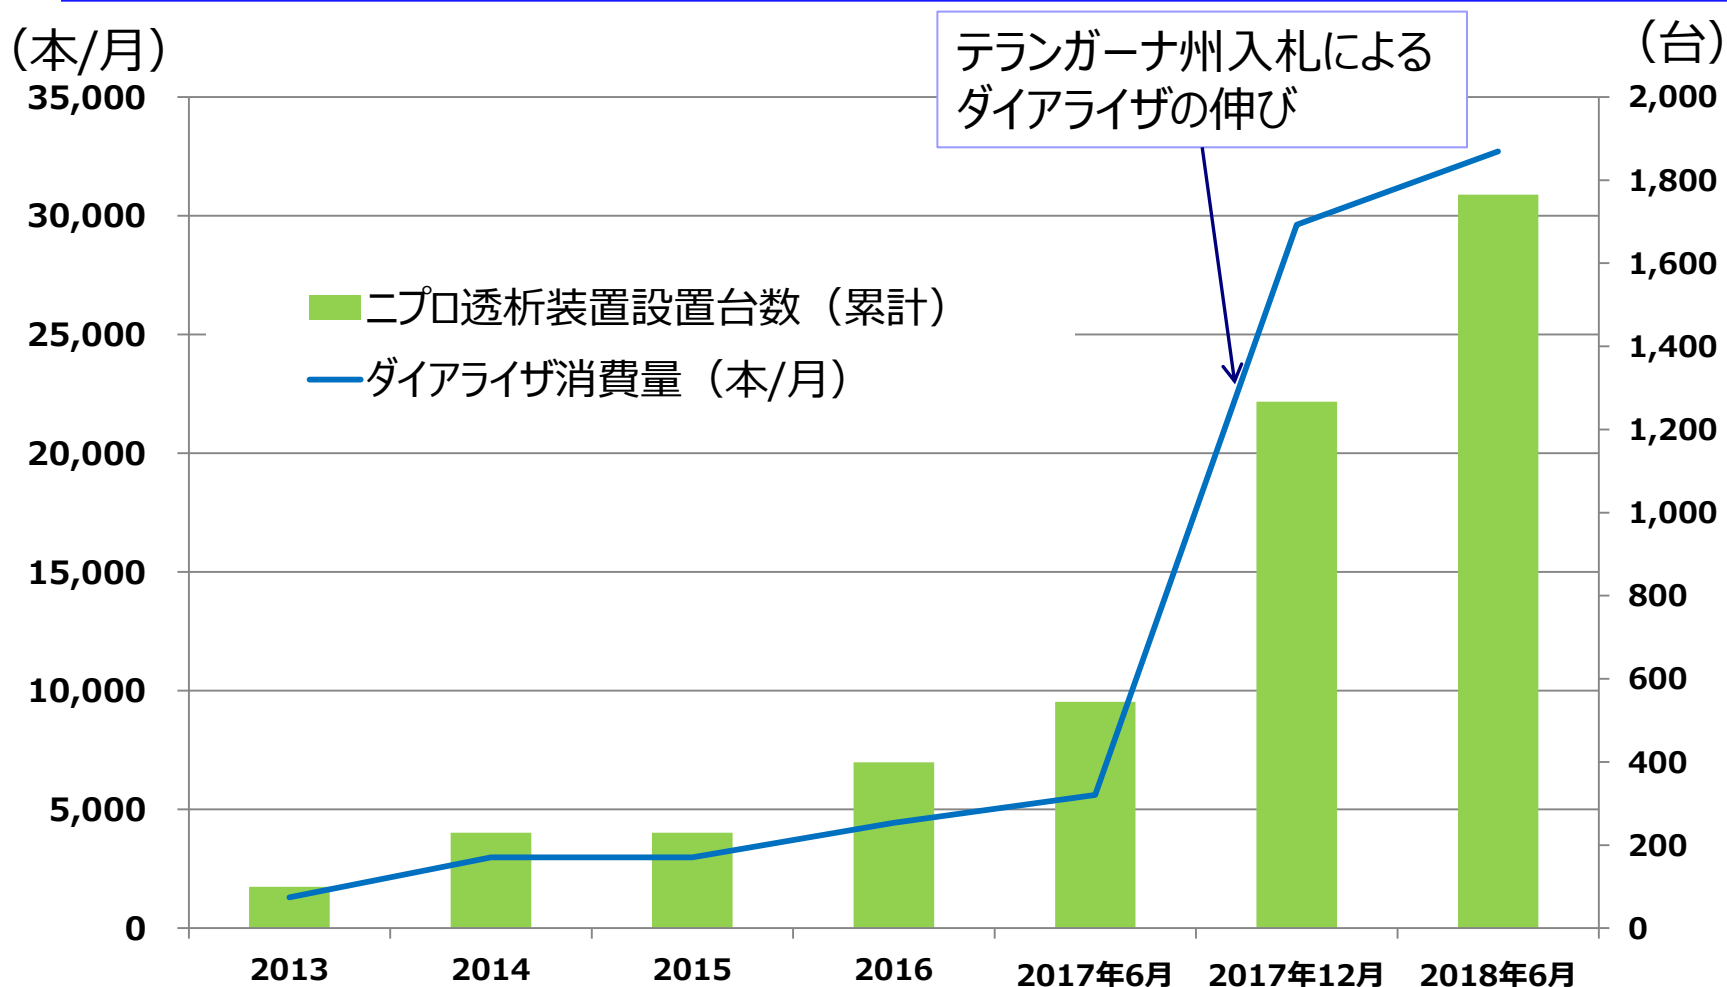

PPPの透析装置設置状況並びにダイアライザ消費量見込み

---

ご清聴ありがとうございました